



義大醫療 2022 年 03 月份床邊檢驗血糖機品管評估結果說明
(機型:FORD S10)(試片批號: TD21J204-BDD)

1. 各單位機台品管操作次數及執行成功率請詳見後表所示。
2. 全院血糖試片品管統計圖表、平均值(Mean)、標準差(SD)、變異係數(CV)請詳見後表所示。
3. 3 月份有 5 個單位品管執行成功率<90%
 - (1)12A，經檢視當月品管執行 73 次，其中 11 次失敗，品管執行成功率為 84.93%。
 - (2)癌-護理之家，經檢視當月品管執行 30 次，其中 6 次失敗，品管執行成功率為 80.0%。
 - (3)癌-5E 負壓隔離病房，經檢視當月品管執行 35 次，其中 4 次失敗，品管執行成功率 88.57%。
 - (4)大昌-嬰兒室，經檢視當月品管執行 34 次，其中 5 次失敗，品管執行成功率為 85.29%。
 - (5)大昌-IMU，經檢視當月品管執行 38 次，其中 10 次失敗，品管執行成功率為 73.68%。

以上單位請加強人員教育訓練，以避免品管異常問題重複發生，下個月將持續觀察其品管表現，其餘單位確實執行血糖機品管，品管執行成功率皆>90%。

4. 本月份統計單位共有 72 個，評估結果經審核後上傳，相關教育訓練及品管執行注意事項請逕行參閱醫學檢驗部網頁，網址為 <http://exdep.edah.org.tw/cp/>。

部長	醫學檢驗部 2022.4.25 鄭雅文 部長	技術主任	2022.4.25 鄭雅文 部長	審核人員	醫檢師 2022-4-22 洪怡仙
----	------------------------------	------	---------------------	------	-------------------------

全院品管統計表 (義大)

查詢日期區間：2022/03/01 ~ 2022/03/31

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
1	A0000002	日間病房	8	8	0	100.00	0.00
2	A0000003	安寧居家	15	15	0	100.00	0.00
3	A0000004	居家護理	67	67	0	100.00	0.00
4	A0000006	美容中心	19	19	0	100.00	0.00
5	A0000010	核醫科	23	23	0	100.00	0.00
6	A0000011	健診	27	27	0	100.00	0.00
7	A0000012	產房	13	13	0	100.00	0.00
8	A0000013	麻醉科	34	34	0	100.00	0.00
9	A0000017	職業醫學科	4	4	0	100.00	0.00
10	A000005A	5A病房	14	13	1	92.86	7.14
11	A000005B	5B病房	31	31	0	100.00	0.00
12	A000006A	6A病房	65	62	3	95.38	4.62
13	A000006B	6B病房	63	62	1	98.41	1.59
14	A000007A	7A病房	64	63	1	98.44	1.56
15	A000007B	7B病房	65	63	2	96.92	3.08
16	A000008A	8A病房	65	64	1	98.46	1.54
17	A000008B	8B病房	67	62	5	92.54	7.46
18	A000009A	9A病房	65	62	3	95.38	4.62
19	A000009B	9B病房	67	63	4	94.03	5.97
20	A000010A	10A病房	58	57	1	98.28	1.72
21	A000011A	11A病房	95	93	2	97.89	2.11
22	A000011B	11B病房	33	31	2	93.94	6.06
23	A000012A	12A病房	73	62	11	84.93	15.07
24	A000012B	12B病房	103	97	6	94.17	5.83
25	A000013A	13A病房	29	29	0	100.00	0.00
26	A000013B	13B病房	64	64	0	100.00	0.00
27	A0000CCU	CCU	32	31	1	96.88	3.13
28	A0000CCU1	CCU隔離病房	30	30	0	100.00	0.00
29	A0000HDR	HDR	72	70	2	97.22	2.78
30	A0000IMU	IMU	34	32	2	94.12	5.88

全院品管統計表

查詢日期區間：2022/03/01 ~ 2022/03/31


編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
31	A0000RCC	RCC	64	62	2	96.88	3.13
32	A000MICU	MICU	64	62	2	96.88	3.13
33	A000PICU	PICU	94	89	5	94.68	5.32
34	A00NSICU	NSICU	65	63	2	96.92	3.08
35	A00SICU1	SICU-1	33	31	2	93.94	6.06
36	A00SICU11	SICU-1隔離病房	31	31	0	100.00	0.00
37	A00SICU2	SICU-2	68	63	5	92.65	7.35
總計			1,818	1,752	66	96.37	3.63

註：所有的統計數值皆是以設定為有效的品管資料為主；若同組品管資料中有一筆被設為無效，則整組資料皆會被排除


試片品管統計圖表 (義大)

查詢年月 : 2022/03

批號試片碼 : TD21J204-BDD

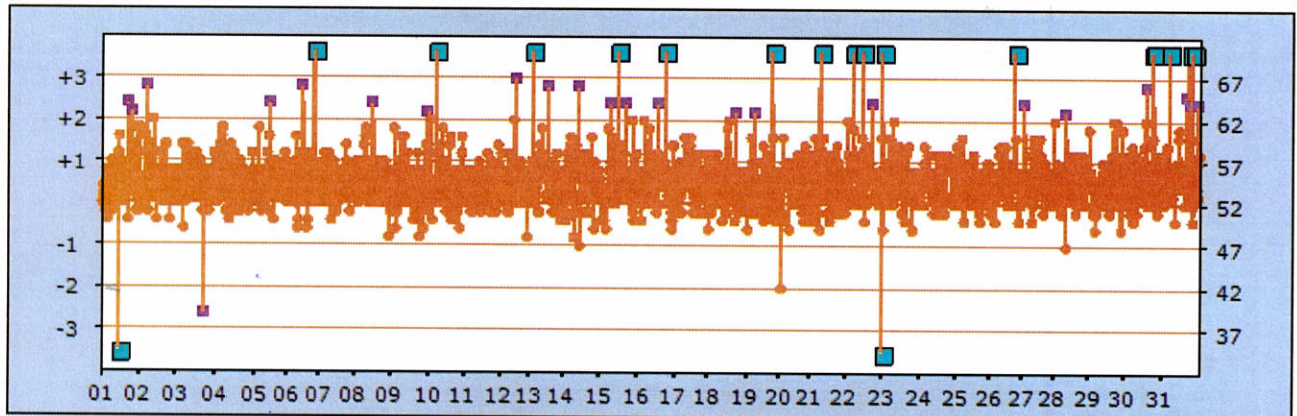

Level1			
Lot Num :	TD21J204-BDD		
N=	1818		
	Record	Target	
Mean :	56.56	52	
SD :	25.11	5	
CV% :	44.4		
Bias(%) :	8.77		
Low :	0	High :	415

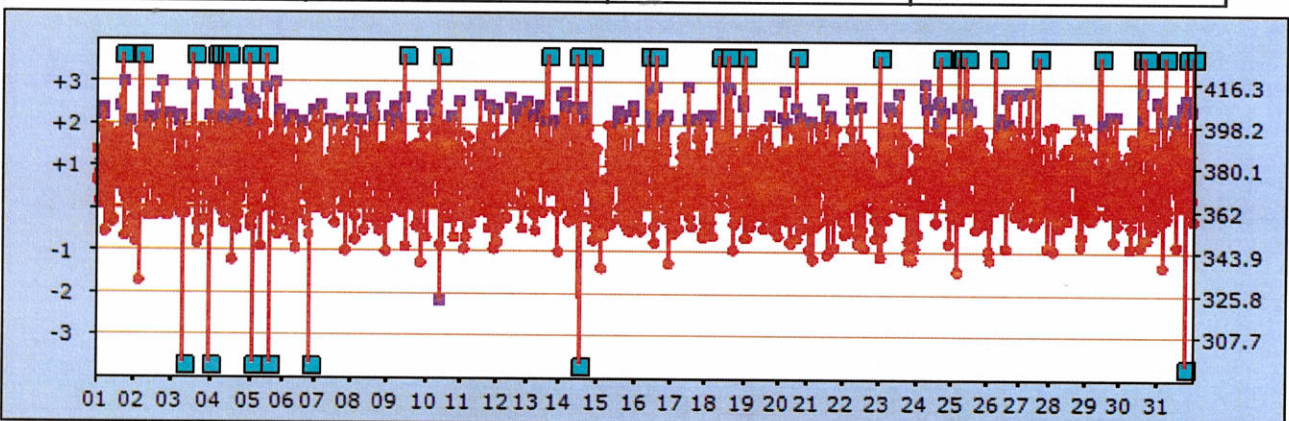

Level3			
Lot Num :	TD21J204-BDD		
N=	1796		
	Record	Target	
Mean :	376.64	362	
SD :	28.24	18.1	
CV% :	7.5		
Bias(%) :	4.04		
Low :	0	High :	454

全院品管統計表 (癌區、大昌)

查詢日期區間：2022/03/01 ~ 2022/03/31

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
1	C0000001	癌-神內	29	29	0	100.00	0.00
2	C0000002	癌-高壓氧中心	13	13	0	100.00	0.00
3	C0000003	癌-透析室	22	21	1	95.45	4.55
4	C0000005	癌-新陳代謝科	32	29	3	90.63	9.38
5	C0000006	癌-護理之家(1)	26	25	1	96.15	3.85
6	C0000007	癌-護理之家(2)	30	24	6	80.00	20.00
7	C000005C	癌-5C	31	31	0	100.00	0.00
8	C000005D	癌-5D	31	31	0	100.00	0.00
9	C000005E	癌-5E負壓隔離病房	35	31	4	88.57	11.43
10	C000006C1	癌-6C-1	31	31	0	100.00	0.00
11	C000006C2	癌-6C-2	31	31	0	100.00	0.00
12	C000006D	癌-6D	64	62	2	96.88	3.13
13	C000007C	癌-7C	66	62	4	93.94	6.06
14	C000007D	癌-7D	64	62	2	96.88	3.13
15	C000008C	癌-8C	71	64	7	90.14	9.86
16	C000008D	癌-8D	66	65	1	98.48	1.52
17	C000009C	癌-9C	66	66	0	100.00	0.00
18	C00000ER	癌-急診	47	43	4	91.49	8.51
19	C0000PD1	癌-血壓櫃台	33	30	3	90.91	9.09
20	C0000PD2	癌-肝膽/家醫	27	27	0	100.00	0.00
21	C0000PD3	癌-門診治療	1	1	0	100.00	0.00
22	C003LICU1	癌-3LICU-1	39	38	1	97.44	2.56
23	C003LICU2	癌-3LICU-2	36	34	2	94.44	5.56
24	D0000001	大昌-麻醉科	4	4	0	100.00	0.00
25	D0000002	大昌-糖尿病衛教室	17	17	0	100.00	0.00
26	D0000003	大昌-嬰兒室	34	29	5	85.29	14.71
27	D0000004	大昌-護理科(董事長)	7	7	0	100.00	0.00
28	D000005G	大昌-5G	31	31	0	100.00	0.00
29	D000006G	大昌-6G	63	62	1	98.41	1.59
30	D00000ER	大昌-急診	56	52	4	92.86	7.14

全院品管統計表

查詢日期區間：2022/03/01 ~ 2022/03/31

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
31	D0000HDR	大昌-HDR	21	21	0	100.00	0.00
32	D0000IMU	大昌-IMU	38	28	10	73.68	26.32
33	D0000PD1	大昌-OPD(1)	34	34	0	100.00	0.00
34	D0000PD2	大昌-OPD(2)	28	28	0	100.00	0.00
35	D00B1OPD	大昌-B1門診	28	27	1	96.43	3.57
總計			1,252	1,190	62	95.05	4.95


註：所有的統計數值皆是以設定為有效的品管資料為主；若同組品管資料中有一筆被設為無效，則整組資料皆會被排除

列印時間 : 2022/04/21 14:39


試片品管統計圖表 (癌症大昌)

查詢年月 : 2022/03

批號試片碼 : TD21J204-BDD

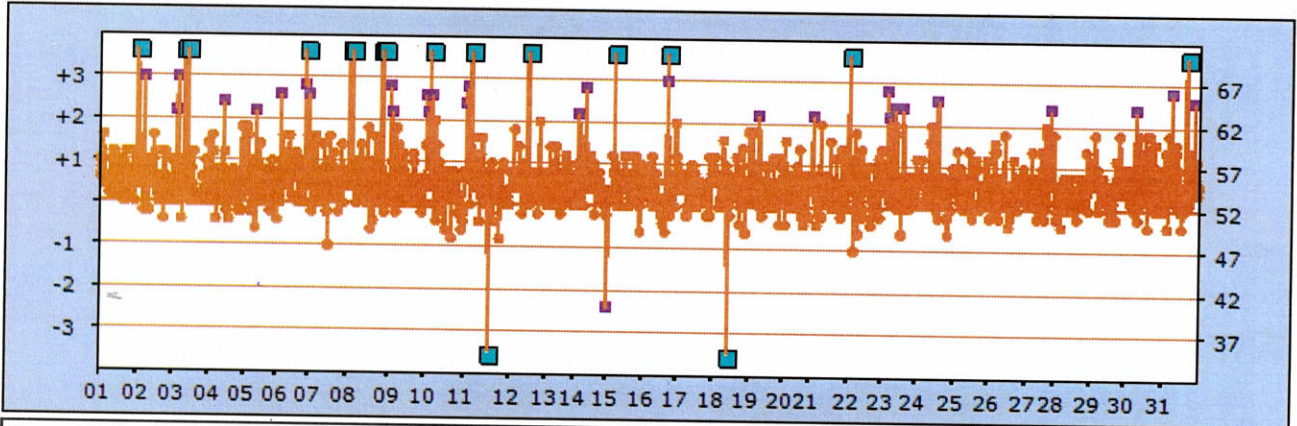

Level1			
Lot Num :	TD21J204-BDD		
N=	1252		
	Record	Target	
Mean :	56.31	52	
SD :	22.14	5	
CV% :	39.32		
Bias(%) :	8.29		
Low :	0	High :	466

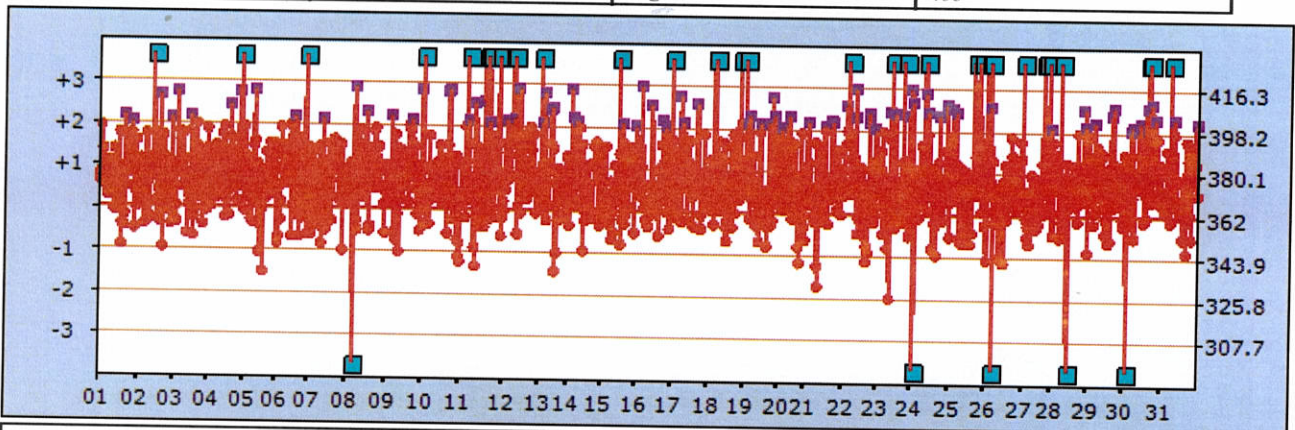

Level3			
Lot Num :	TD21J204-BDD		
N=	1228		
	Record	Target	
Mean :	375.84	362	
SD :	24.57	18.1	
CV% :	6.54		
Bias(%) :	3.82		
Low :	57	High :	568