



義大醫療 2026 年 07 月份床邊檢驗血糖機品管評估結果說明
(機型:FORD S10)
(試片批號: TD24J108-BED、TD25H129-BDD)

1. 各單位機台品管操作次數及執行成功率請詳見後表所示。
2. 全院血糖試片品管統計圖表、平均值(Mean)、標準差(SD)、變異係數(CV)請詳見後表所示。
3. 7 月份有 **1** 個單位品管執行成功率<90%

(1) **癌-8D**，經檢視當月品管執行 69 次，其中 7 次失敗，品管執行成功率為 **89.86%**。

- 3.1 **癌-8D** 經檢視品管執行狀況，7 次異常內分別有 4 次為高值品管液數值偏高，2 次為低值品管液數值偏高，以及 1 次高低值品管液錯置，單位應加強人員教育訓練，避免品管液錯置問題。

建議以上使用單位，品管液使用前應確實搖晃均勻，第一滴丟棄後再測試，使用完畢後品管液蓋子擦拭乾淨，以免造成汙染，單位應加強人員教育訓練，下個月將持續觀察。

- 3.2 其餘單位確實執行血糖機品管，品管執行成功率皆>90%。

4. 本月份統計單位共有 **68** 個，評估結果經審核後上傳，相關教育訓練及品管執行注意事項請逕行參閱醫學檢驗部網頁，網址為 <http://exdep.edah.org.tw/cp/>。

部長	醫學檢驗部 2026.8.25 鄭雅文 部長	技術主任	技術主任 2026.8.27 潘冠頤	技術主任 2026.8.24 許欽豪	技術主任 2026-8-20 江亭蕙	審核人員	醫檢師 2026-8-20 洪怡仙
----	------------------------------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------	-------------------------

全院品管統計表

查詢日期區間：2026/07/01 ~ 2026/07/31

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
1	A0000001	化療中心	23	23	0	100.00	0.00
2	A0000002	日間病房	4	4	0	100.00	0.00
3	A0000004	居家護理	76	72	4	94.74	5.26
4	A0000006	美容中心	7	7	0	100.00	0.00
5	A0000008	家醫科(偏鄉)	4	4	0	100.00	0.00
6	A0000009	家醫科居家訪視	4	4	0	100.00	0.00
7	A0000010	核醫科	23	23	0	100.00	0.00
8	A0000011	健診	27	27	0	100.00	0.00
9	A0000012	產房	9	9	0	100.00	0.00
10	A0000013	麻醉科	47	47	0	100.00	0.00
11	A0000017	職業醫學科	3	3	0	100.00	0.00
12	A000005A	5A病房	15	15	0	100.00	0.00
13	A000005B	5B病房	31	31	0	100.00	0.00
14	A000006A	6A病房	61	61	0	100.00	0.00
15	A000006B	6B病房	64	64	0	100.00	0.00
16	A000007A	7A病房	65	63	2	96.92	3.08
17	A000007B	7B病房	62	62	0	100.00	0.00
18	A000008A	8A病房	61	61	0	100.00	0.00
19	A000008B	8B病房	63	63	0	100.00	0.00
20	A000009A	9A病房	62	62	0	100.00	0.00
21	A000009B	9B病房	64	63	1	98.44	1.56
22	A00000ER	急診	181	173	8	95.58	4.42
23	A000010A	10A病房	62	62	0	100.00	0.00
24	A000011A	11A病房	59	57	2	96.61	3.39
25	A000011B	11B病房	64	62	2	96.88	3.13
26	A000012A	12A病房	58	57	1	98.28	1.72
27	A000012B	12B病房	95	94	1	98.95	1.05
28	A000013A	13A病房	92	87	5	94.57	5.43
29	A000013B	13B病房	62	61	1	98.39	1.61
30	A0000CCU	CCU	59	59	0	100.00	0.00

全院品管統計表

查詢日期區間：2026/07/01 ~ 2026/07/31

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
31	A0000HDR	HDR	82	78	4	95.12	4.88
32	A0000IMU	IMU	33	31	2	93.94	6.06
33	A0000RCC	RCC	58	56	2	96.55	3.45
34	A000MICU	MICU	66	64	2	96.97	3.03
35	A000PICU	PICU	96	93	3	96.88	3.13
36	A00NSICU	NSICU	69	63	6	91.30	8.70
37	A00SICU1	SICU	61	61	0	100.00	0.00
38	A00SICU2	SICU-2	62	57	5	91.94	8.06
	總計		2,034	1,983	51	97.49	2.51

註：所有的統計數值皆是以設定為有效的品管資料為主；若同組品管資料中有一筆被設為無效，則整組資料皆會被排除

全院品管統計表

查詢日期區間：2026/07/01 ~ 2026/07/31

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
1	C0000002	癌-高壓氧中心	14	14	0	100.00	0.00
2	C0000003	癌-透析室	23	23	0	100.00	0.00
3	C0000006	癌-護理之家	96	92	4	95.83	4.17
4	C000005C	癌-5C	30	30	0	100.00	0.00
5	C000005D	癌-5D	30	30	0	100.00	0.00
6	C000006C1	癌-6C	64	63	1	98.44	1.56
7	C000006D	癌-6D	60	60	0	100.00	0.00
8	C000007C	癌-7C	61	61	0	100.00	0.00
9	C000007D	癌-7D	66	63	3	95.45	4.55
10	C000008C	癌-8C	62	62	0	100.00	0.00
11	C000008D	癌-8D	69	62	7	89.86	10.14
12	C00000ER	癌-急診	62	62	0	100.00	0.00
13	C003LICU1	癌-3LICU	61	61	0	100.00	0.00
14	D0000001	大昌-麻醉科	1	1	0	100.00	0.00
15	D0000002	大昌-糖尿病衛教室	11	11	0	100.00	0.00
16	D0000003	大昌-嬰兒室	31	30	1	96.77	3.23
17	D0000004	大昌-護理科(董事長)	2	2	0	100.00	0.00
18	D0000010H	大昌-10H	32	32	0	100.00	0.00
19	D000005G	大昌-5G	32	32	0	100.00	0.00
20	D000006G	大昌-6G	70	66	4	94.29	5.71
21	D000008J	大昌-8J	33	31	2	93.94	6.06
22	D000009G	大昌-9G	66	64	2	96.97	3.03
23	D000009H	大昌-9H	68	65	3	95.59	4.41
24	D00000ER	大昌-急診	65	62	3	95.38	4.62
25	D0000HDR	大昌-HDR	24	24	0	100.00	0.00
26	D00001MU	大昌-1MU	30	29	1	96.67	3.33
27	D0000PD2	大昌-OPD(2)	31	31	0	100.00	0.00
28	D00B1OPD	大昌-B1門診	56	56	0	100.00	0.00
總計			1,250	1,219	31	97.52	2.48

註：所有的統計數值皆是以設定為有效的品管資料為主；若同組品管資料中有一筆被設為無效，則整組資料皆會被排除

全院品管統計表

查詢日期區間：2026/07/01 ~ 2026/07/31

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
1	A0000PD1	義大醫院門診	227	222	5	97.80	2.20
2	C0000PD1	癌醫-門診	101	100	1	99.01	0.99
	總計		328	322	6	98.17	1.83


註：所有的統計數值皆是以設定為有效的品管資料為主；若同組品管資料中有一筆被設為無效，則整組資料皆會被排除

(義大)
試片品管統計圖表


列印時間：2026/08/14 10:30

查詢年月：2026/07

批號試片碼：TD24J108-BED

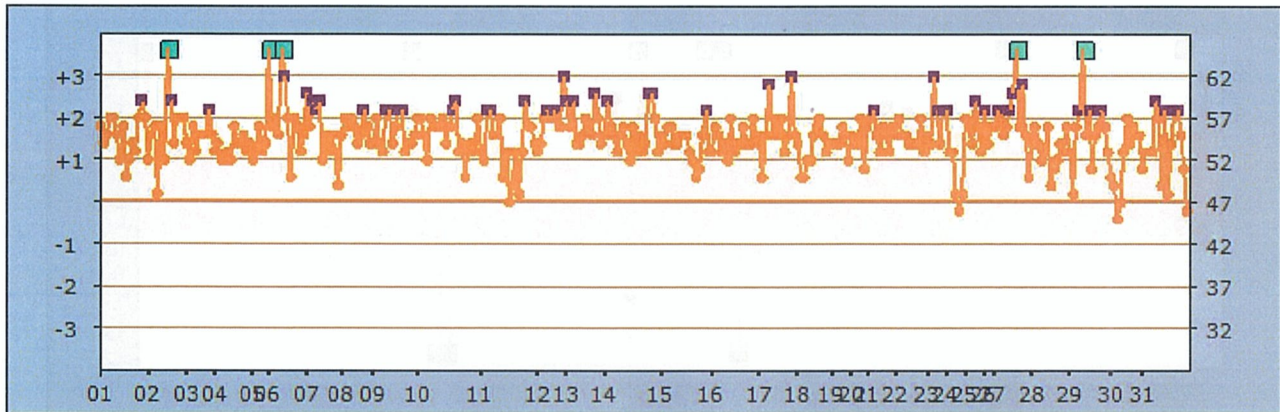

Level1			
Lot Num :	TD24J108-BED		
N=	344		
	Record	Target	
Mean :	54.91	47	
SD :	3.06	5	
CV% :	5.57		
Bias(%) :	16.83		
Low :	45	High :	68

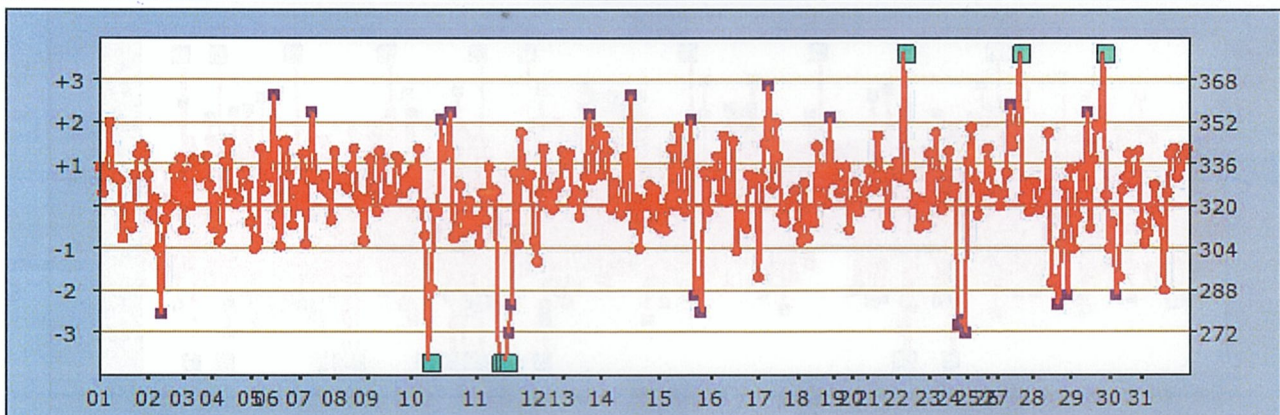


Level3			
Lot Num :	TD24J108-BED		
N=	339		
	Record	Target	
Mean :	325.14	320	
SD :	17.38	16	
CV% :	5.35		
Bias(%) :	1.61		
Low :	262	High :	373


試片品管統計圖表

查詢年月：2026/07

批號試片碼：TD25H129-BDD

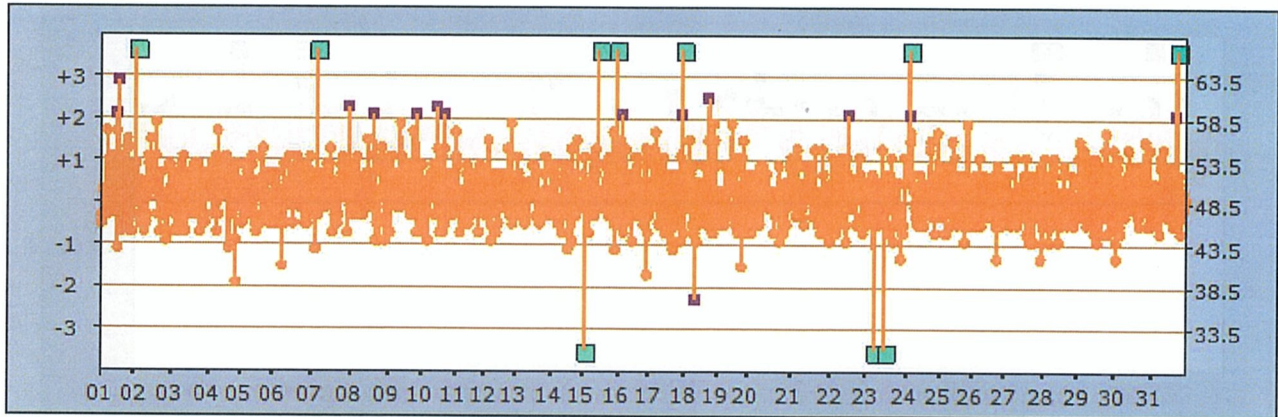

Level1			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	1690		
	Record	Target	
Mean :	49.96	48.5	
SD :	11.08	5	
CV% :	22.18		
Bias(%) :	3.01		
Low :	3	High :	305

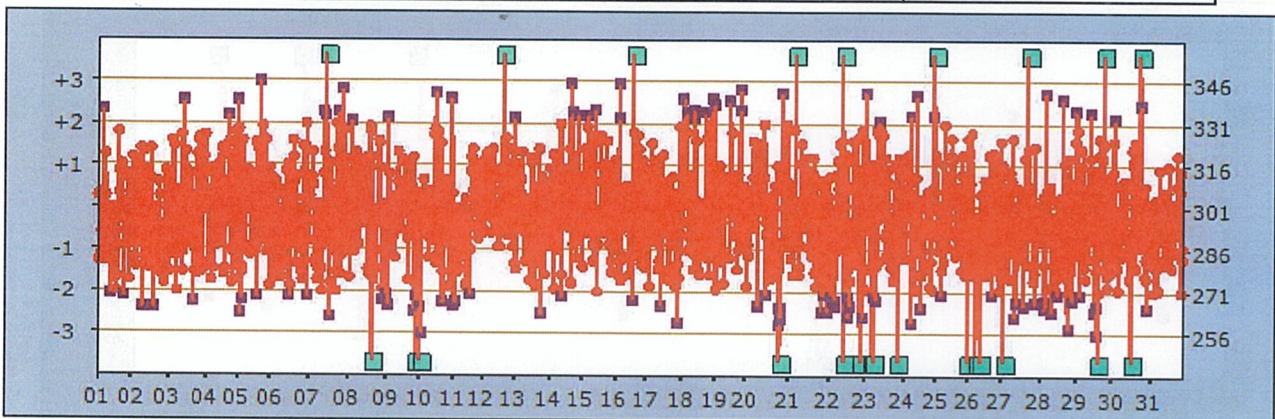

Level3			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	1677		
	Record	Target	
Mean :	297.58	301	
SD :	23.83	15	
CV% :	8.01		
Bias(%) :	1.14		
Low :	0	High :	462


(癌匠-大昌)

列印時間 : 2026/08/14 10:32


試片品管統計圖表

查詢年月 : 2026/07

批號試片碼 : TD24J108-BED

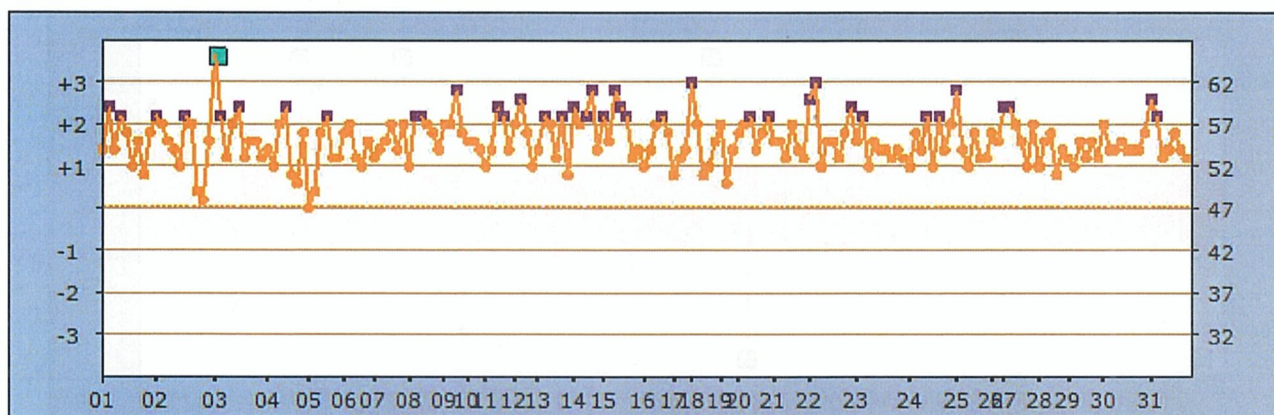

Level1			
Lot Num :	TD24J108-BED		
N=	185		
	Record	Target	
Mean :	55.5	47	
SD :	5.74	5	
CV% :	10.34		
Bias(%) :	18.09		
Low :	47	High :	124

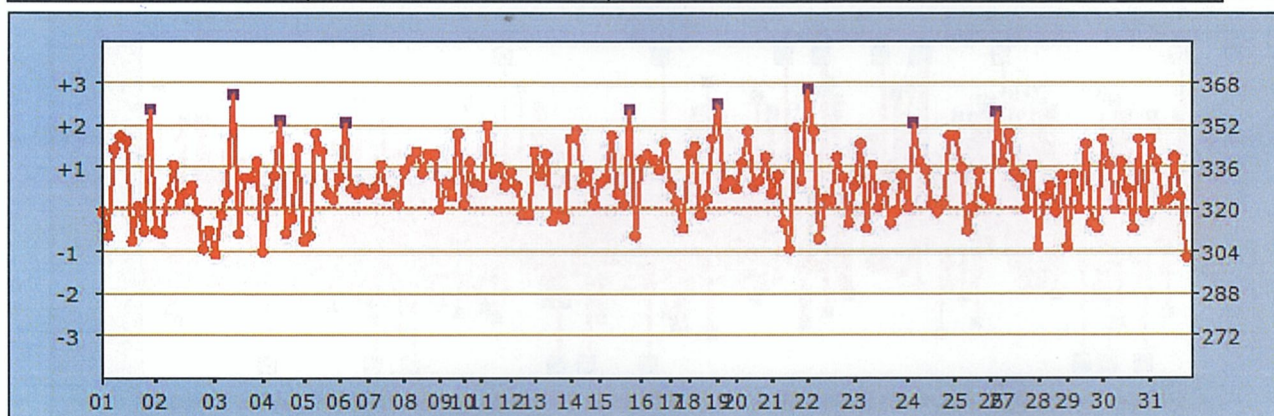


Level3			
Lot Num :	TD24J108-BED		
N=	184		
	Record	Target	
Mean :	329.98	320	
SD :	13.38	16	
CV% :	4.05		
Bias(%) :	3.12		
Low :	302	High :	366


試片品管統計圖表

查詢年月：2026/07

批號試片碼：TD25H129-BDD

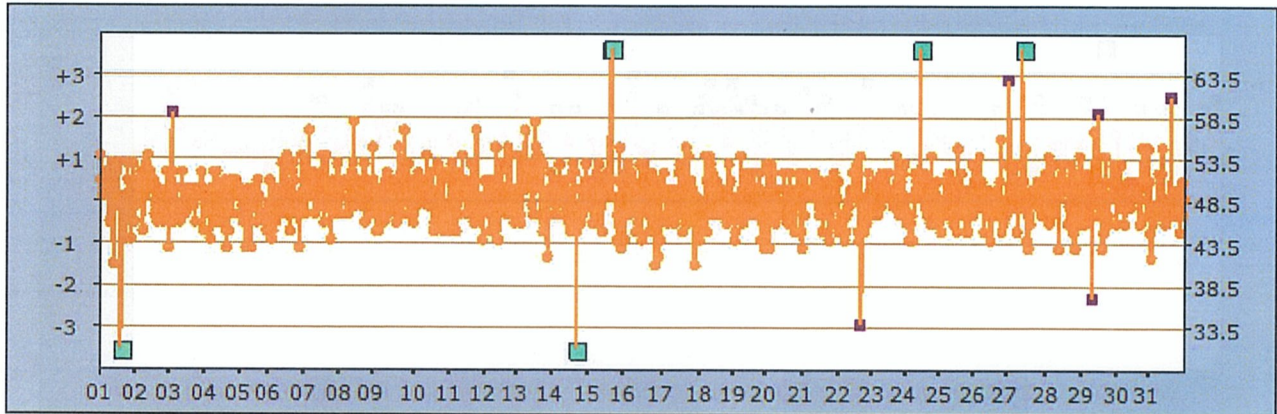

Level1			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	1065		
	Record	Target	
Mean :	49.36	48.5	
SD :	10.97	5	
CV% :	22.22		
Bias(%) :	1.77		
Low :	0	High :	298

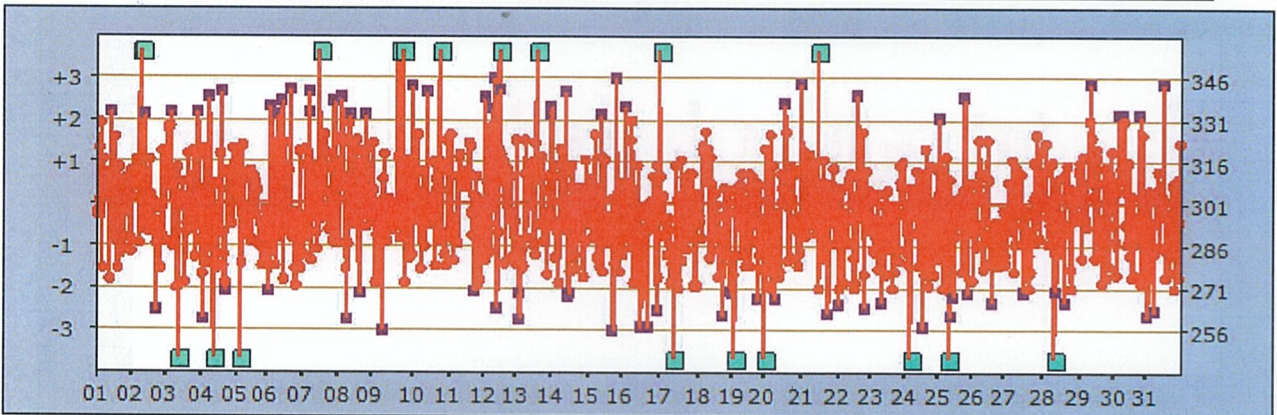


Level3			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	1055		
	Record	Target	
Mean :	298.31	301	
SD :	23.65	15	
CV% :	7.93		
Bias(%) :	0.89		
Low :	48	High :	435

(義大醫院+慈惠醫院)
試片品管統計圖表


列印時間：2026/08/14 10:34

查詢年月：2026/07

批號試片碼：TD24J108-BED

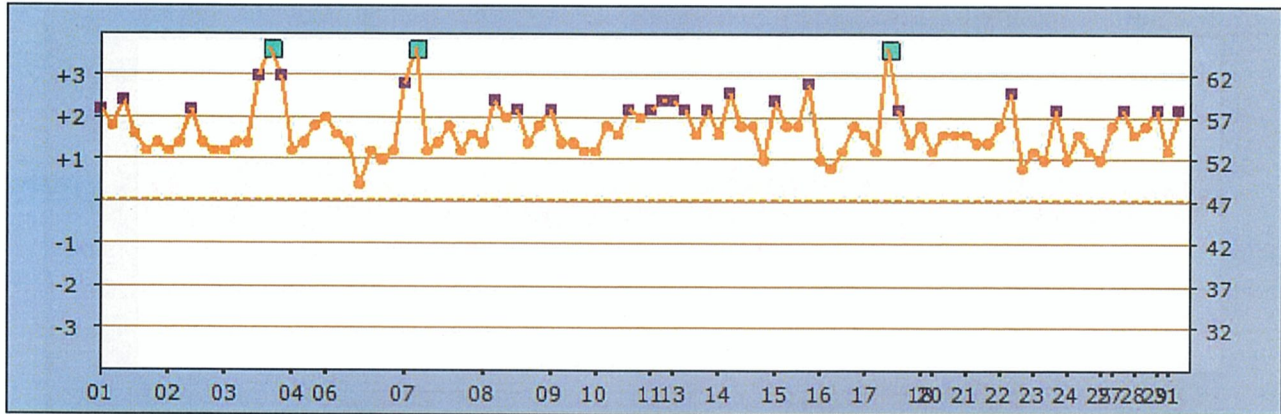

Level1			
Lot Num :	TD24J108-BED		
N=	97		
	Record	Target	
Mean :	55.89	47	
SD :	4.33	5	
CV% :	7.75		
Bias(%) :	18.91		
Low :	49	High :	87

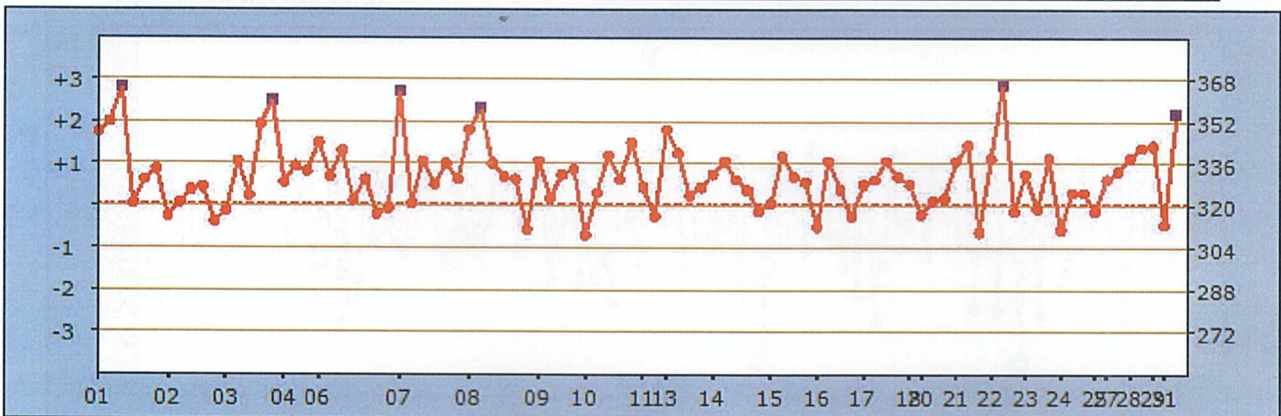


Level3			
Lot Num :	TD24J108-BED		
N=	94		
	Record	Target	
Mean :	331.22	320	
SD :	12.56	16	
CV% :	3.79		
Bias(%) :	3.51		
Low :	309	High :	366


試片品管統計圖表

查詢年月：2026/07

批號試片碼：TD25H129-BDD

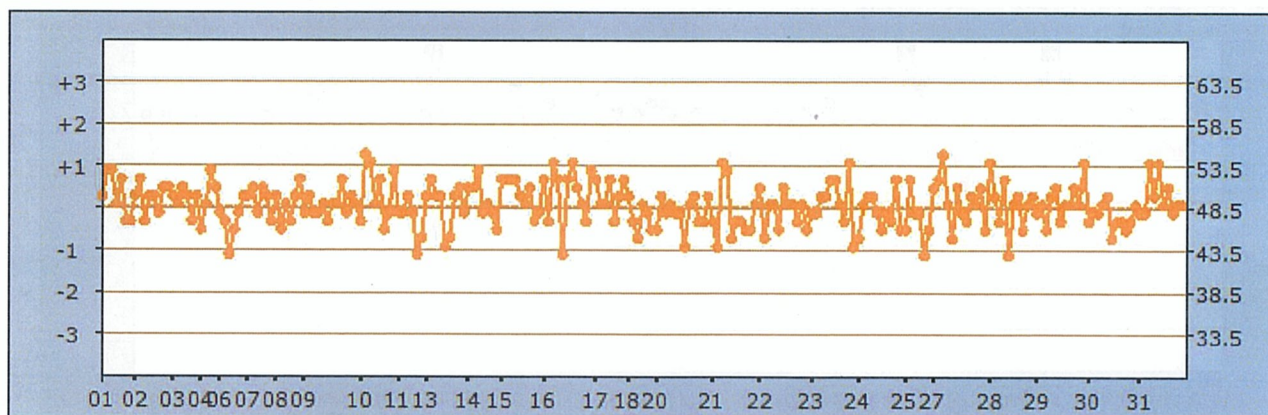

Level1			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	231		
	Record	Target	
Mean :	48.98	48.5	
SD :	2.51	5	
CV% :	5.12		
Bias(%) :	0.99		
Low :	43	High :	55

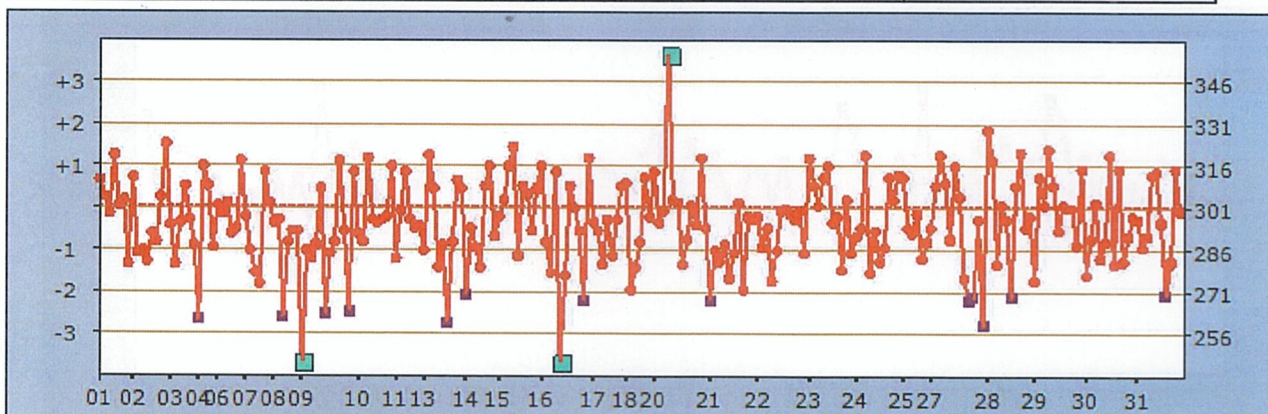

Level3			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	231		
	Record	Target	
Mean :	294.97	301	
SD :	22.36	15	
CV% :	7.58		
Bias(%) :	2		
Low :	48	High :	347