



義大醫療 2026 年 09 月份床邊檢驗血糖機品管評估結果說明
(機型:FORD S10)
(試片批號: TD24J108-BED、TD25H129-BDD)

1. 各單位機台品管操作次數及執行成功率請詳見後表所示。
2. 全院血糖試片品管統計圖表、平均值(Mean)、標準差(SD)、變異係數(CV)請詳見後表所示。
3. 9 月份所有單位確實執行血糖機品管，品管執行成功率皆>90%。
4. 本月份統計單位共有 **68** 個，評估結果經審核後上傳，相關教育訓練及品管執行注意事項請逕行參閱醫學檢驗部網頁，網址為 <http://exdep.edah.org.tw/cp/>。

部長		技術主任	  	審核人員	
----	---	------	--	------	---

全院品管統計表

查詢日期區間：2026/09/01 ~ 2026/09/30

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
1	A0000001	化療中心	21	21	0	100.00	0.00
2	A0000002	日間病房	6	6	0	100.00	0.00
3	A0000004	居家護理	73	73	0	100.00	0.00
4	A0000006	美容中心	11	11	0	100.00	0.00
5	A0000008	家醫科(偏鄉)	5	5	0	100.00	0.00
6	A0000009	家醫科居家訪視	7	7	0	100.00	0.00
7	A0000010	核醫科	20	20	0	100.00	0.00
8	A0000011	健診	24	24	0	100.00	0.00
9	A0000012	產房	12	12	0	100.00	0.00
10	A0000013	麻醉科	49	45	4	91.84	8.16
11	A0000017	職業醫學科	7	7	0	100.00	0.00
12	A000005A	5A病房	10	10	0	100.00	0.00
13	A000005B	5B病房	31	31	0	100.00	0.00
14	A000006A	6A病房	62	60	2	96.77	3.23
15	A000006B	6B病房	61	60	1	98.36	1.64
16	A000007A	7A病房	62	60	2	96.77	3.23
17	A000007B	7B病房	64	60	4	93.75	6.25
18	A000008A	8A病房	61	60	1	98.36	1.64
19	A000008B	8B病房	62	60	2	96.77	3.23
20	A000009A	9A病房	60	60	0	100.00	0.00
21	A000009B	9B病房	51	48	3	94.12	5.88
22	A000000ER	急診	179	163	16	91.06	8.94
23	A000010A	10A病房	60	60	0	100.00	0.00
24	A000011A	11A病房	57	54	3	94.74	5.26
25	A000011B	11B病房	64	61	3	95.31	4.69
26	A000012A	12A病房	63	60	3	95.24	4.76
27	A000012B	12B病房	91	91	0	100.00	0.00
28	A000013A	13A病房	91	90	1	98.90	1.10
29	A000013B	13B病房	61	60	1	98.36	1.64
30	A0000CCU	CCU	62	60	2	96.77	3.23

全院品管統計表

查詢日期區間：2026/09/01 ~ 2026/09/30

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
31	A0000HDR	HDR	80	76	4	95.00	5.00
32	A0000IMU	IMU	30	30	0	100.00	0.00
33	A0000RCC	RCC	51	50	1	98.04	1.96
34	A000MICU	MICU	57	54	3	94.74	5.26
35	A000PICU	PICU	88	87	1	98.86	1.14
36	A00NSICU	NSICU	61	60	1	98.36	1.64
37	A00SICU1	SICU	65	60	5	92.31	7.69
38	A00SICU2	SICU-2	60	59	1	98.33	1.67

註：所有的統計數值皆是以設定為有效的品管資料為主；若同組品管資料中有一筆被設為無效，則整組資料皆會被排除

全院品管統計表

查詢日期區間：2026/09/01 ~ 2026/09/30

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
1	C0000002	癌-高壓氧中心	12	12	0	100.00	0.00
2	C0000003	癌-透析室	24	24	0	100.00	0.00
3	C0000006	癌-護理之家	91	86	5	94.51	5.49
4	C000005C	癌-5C	31	29	2	93.55	6.45
5	C000005D	癌-5D	29	29	0	100.00	0.00
6	C000006C1	癌-6C	64	62	2	96.88	3.13
7	C000006D	癌-6D	61	60	1	98.36	1.64
8	C000007C	癌-7C	61	60	1	98.36	1.64
9	C000007D	癌-7D	60	60	0	100.00	0.00
10	C000008C	癌-8C	62	60	2	96.77	3.23
11	C000008D	癌-8D	60	60	0	100.00	0.00
12	C00000ER	癌-急診	62	60	2	96.77	3.23
13	C003LICU1	癌-3LICU	65	63	2	96.92	3.08
14	D0000001	大昌-麻醉科	1	1	0	100.00	0.00
15	D0000002	大昌-糖尿病衛教室	12	12	0	100.00	0.00
16	D0000003	大昌-嬰兒室	32	31	1	96.88	3.13
17	D0000004	大昌-護理科(董事長)	4	4	0	100.00	0.00
18	D0000010H	大昌-10H	31	30	1	96.77	3.23
19	D000005G	大昌-5G	30	30	0	100.00	0.00
20	D000006G	大昌-6G	58	57	1	98.28	1.72
21	D000008J	大昌-8J	31	30	1	96.77	3.23
22	D000009G	大昌-9G	62	60	2	96.77	3.23
23	D000009H	大昌-9H	63	60	3	95.24	4.76
24	D00000ER	大昌-急診	50	50	0	100.00	0.00
25	D0000HDR	大昌-HDR	25	24	1	96.00	4.00
26	D0000IMU	大昌-IMU	29	29	0	100.00	0.00
27	D0000PD2	大昌-OPD(2)	24	24	0	100.00	0.00
28	D00B1OPD	大昌-B1門診	50	50	0	100.00	0.00

註：所有的統計數值皆是以設定為有效的品管資料為主；若同組品管資料中有一筆被設為無效，則整組資料皆會被排除

列印時間：2026/10/16 09:34

全院品管統計表

查詢日期區間：2026/09/01 ~ 2026/09/30

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
1	A0000PD1	義大醫院門診	203	200	3	98.52	1.48
2	C0000PD1	癌醫門診	103	100	3	97.09	2.91

註：所有的統計數值皆是以設定為有效的品管資料為主；若同組品管資料中有一筆被設為無效，則整組資料皆會被排除


(美大)

列印時間：2026/10/16 09:30


試片品管統計圖表

查詢年月：2026/09

批號試片碼：TD24J108-BED

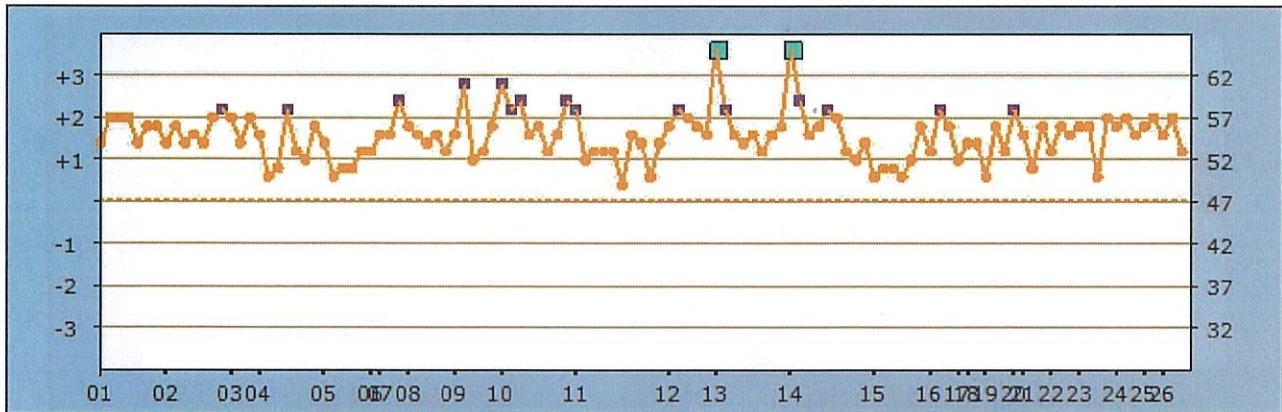

Level1			
Lot Num :	TD24J108-BED		
N=	117		
	Record	Target	
Mean :	54.97	47	
SD :	2.97	5	
CV% :	5.4		
Bias(%) :	16.96		
Low :	49	High :	70

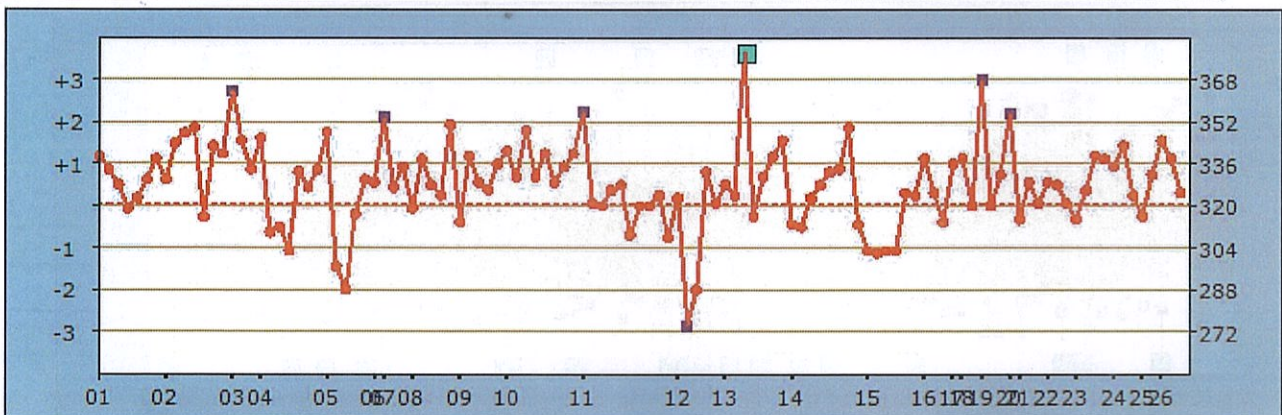


Level3			
Lot Num :	TD24J108-BED		
N=	115		
	Record	Target	
Mean :	328.68	320	
SD :	16.56	16	
CV% :	5.04		
Bias(%) :	2.71		
Low :	274	High :	398


試片品管統計圖表

查詢年月：2026/09

批號試片碼：TD25H129-BDD

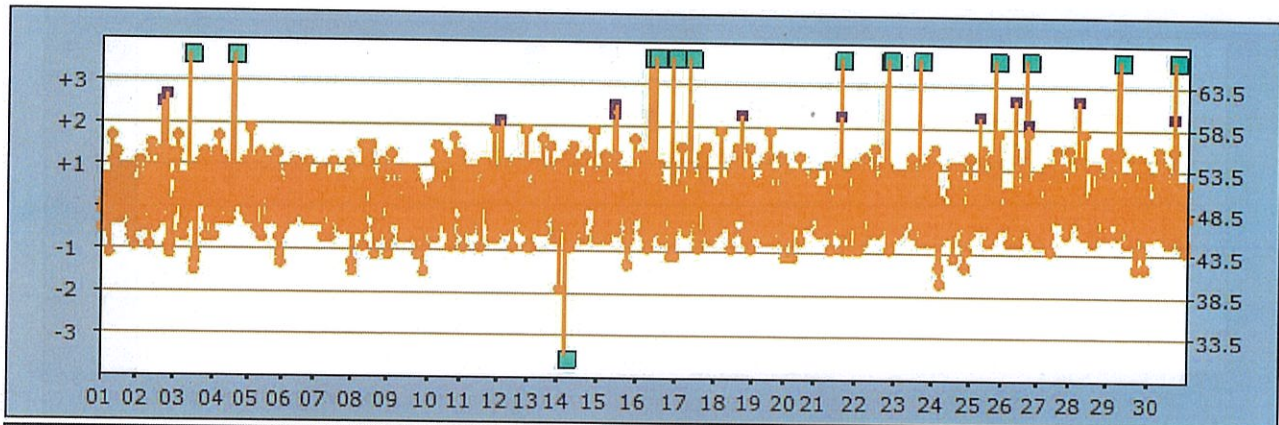

Level1			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	1863		
	Record	Target	
Mean :	50.93	48.5	
SD :	17.29	5	
CV% :	33.95		
Bias(%) :	5.01		
Low :	0	High :	310

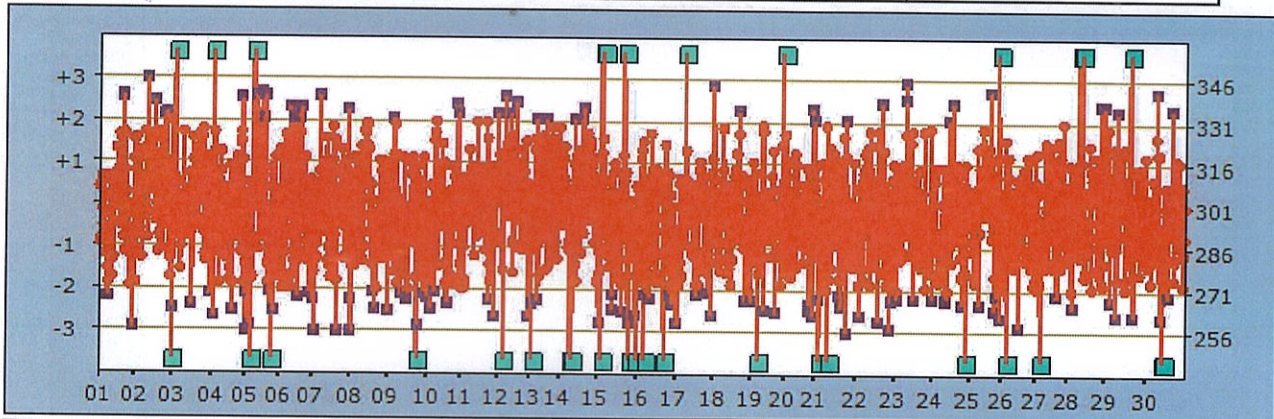

Level3			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	1840		
	Record	Target	
Mean :	297.22	301	
SD :	25.08	15	
CV% :	8.44		
Bias(%) :	1.26		
Low :	0	High :	465


(癌胚、大腸)

列印時間：2026/10/16 09:33


試片品管統計圖表

查詢年月：2026/09

批號試片碼：TD24J108-BED

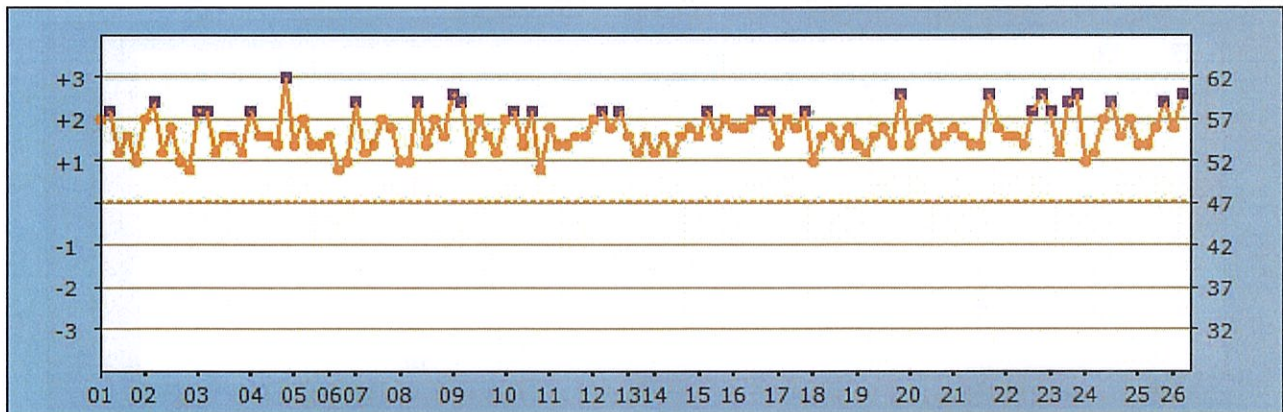

Level1			
Lot Num :	TD24J108-BED		
N=	124		
	Record	Target	
Mean :	55.58	47	
SD :	2.3	5	
CV% :	4.14		
Bias(%) :	18.26		
Low :	51	High :	62

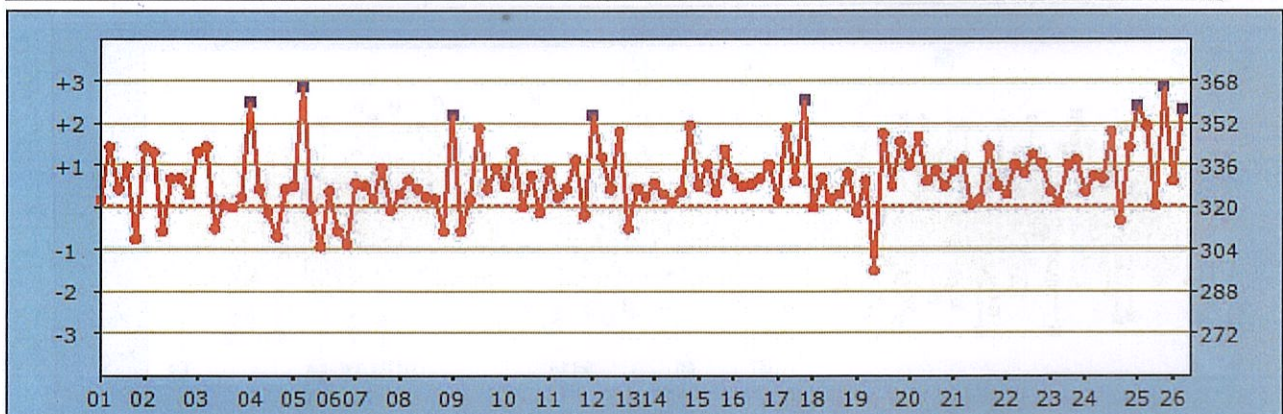


Level3			
Lot Num :	TD24J108-BED		
N=	124		
	Record	Target	
Mean :	330.68	320	
SD :	12.9	16	
CV% :	3.9		
Bias(%) :	3.34		
Low :	296	High :	366


試片品管統計圖表

查詢年月：2026/09

批號試片碼：TD25H129-BDD

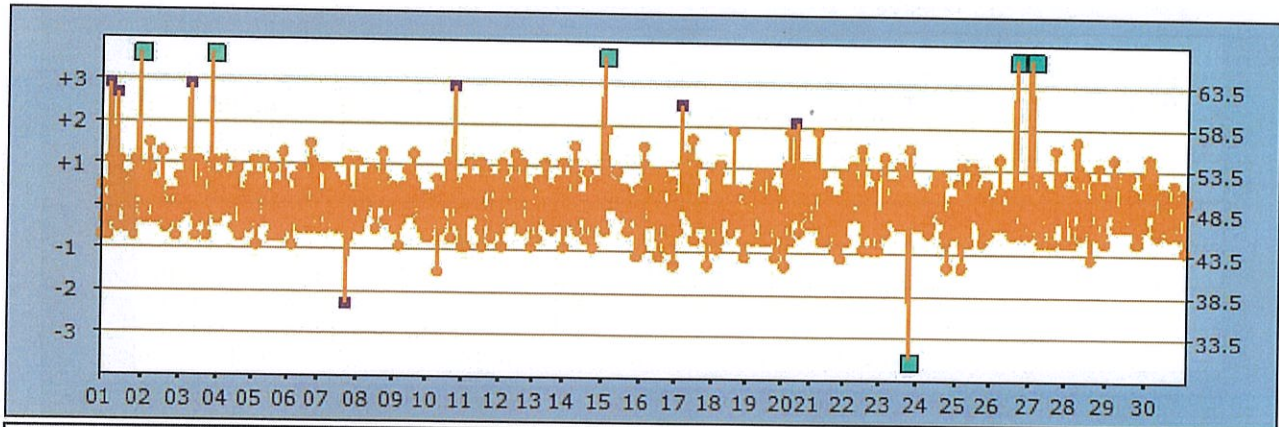

Level1		
Lot Num :	TD25H129-BDD	
N=	1060	
	Record	Target
Mean :	50.22	48.5
SD :	16.2	5
CV% :	32.26	
Bias(%) :	3.55	
Low :	0	High : 324

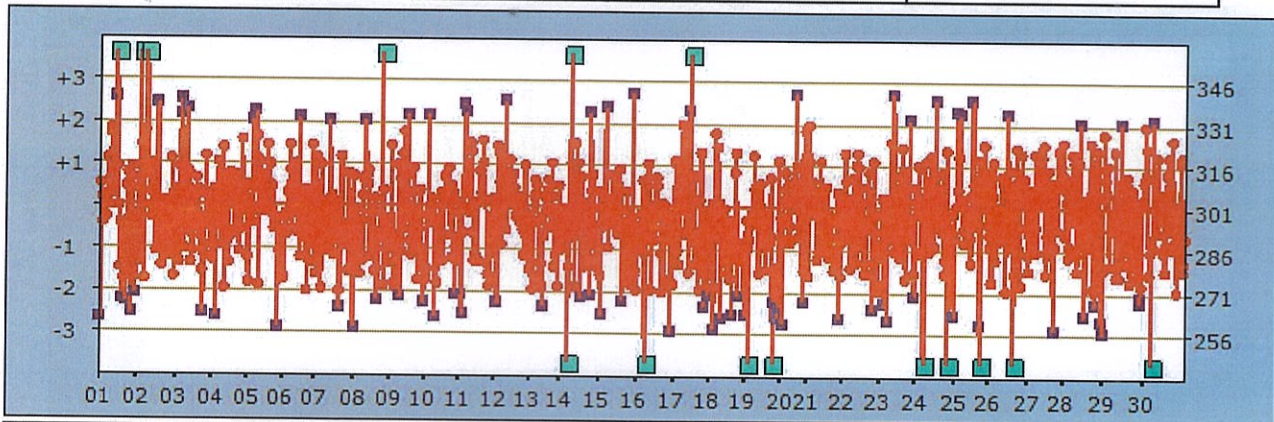


Level3		
Lot Num :	TD25H129-BDD	
N=	1048	
	Record	Target
Mean :	297.24	301
SD :	18.98	15
CV% :	6.39	
Bias(%) :	1.25	
Low :	56	High : 380

(義門診+癌區門診)
試片品管統計圖表


列印時間：2026/10/16 09:34

查詢年月：2026/09

批號試片碼：TD24J108-BED

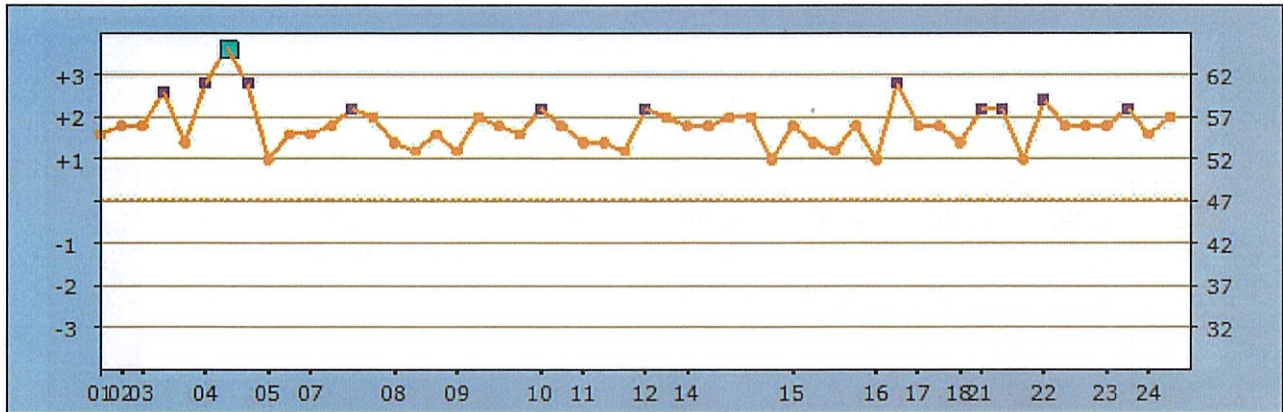

Level1			
Lot Num :	TD24J108-BED		
N=	52		
	Record	Target	
Mean :	56.02	47	
SD :	2.46	5	
CV% :	4.39		
Bias(%) :	19.19		
Low :	52	High :	63

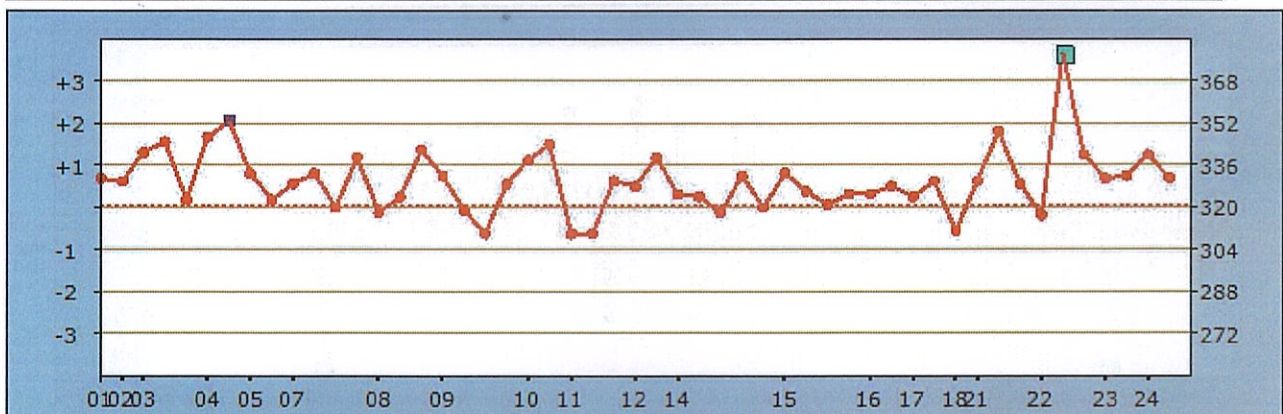


Level3			
Lot Num :	TD24J108-BED		
N=	51		
	Record	Target	
Mean :	330.08	320	
SD :	11.76	16	
CV% :	3.56		
Bias(%) :	3.15		
Low :	310	High :	373


試片品管統計圖表

查詢年月：2026/09

批號試片碼：TD25H129-BDD

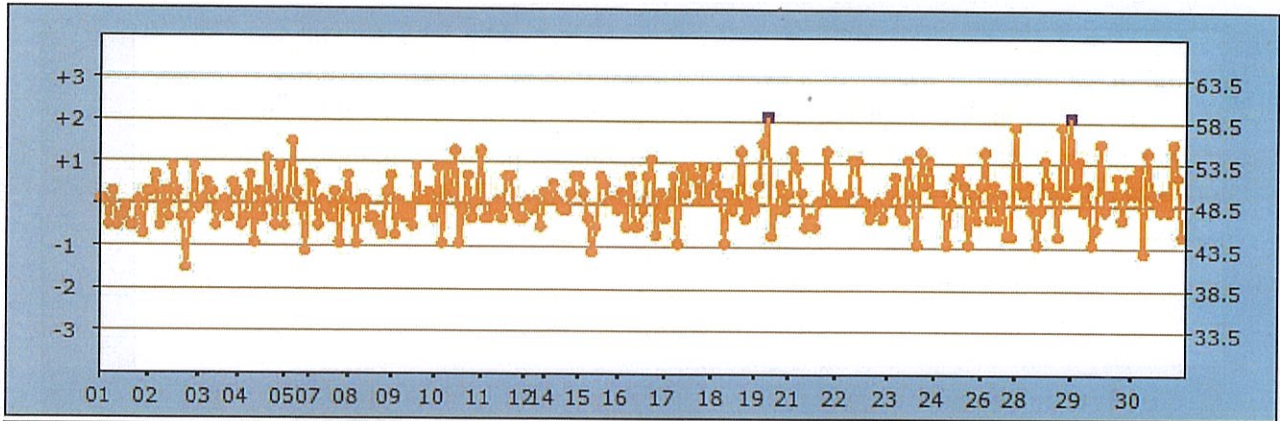

Level1			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	254		
	Record	Target	
Mean :	49.29	48.5	
SD :	3.12	5	
CV% :	6.33		
Bias(%) :	1.63		
Low :	41	High :	59

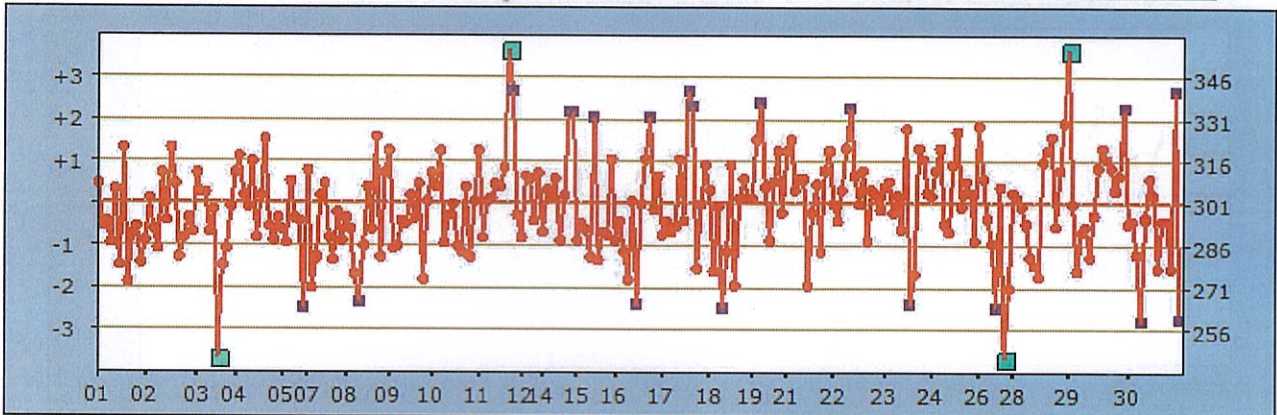

Level3			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	254		
	Record	Target	
Mean :	299.28	301	
SD :	23.59	15	
CV% :	7.88		
Bias(%) :	0.57		
Low :	45	High :	356